



# ESQUEMA DE INSERCIÓN SHINER



En el caso que el hueso tenga una consistencia D1 y D2, se aconseja el uso de los rosqueadores de hueso de la línea SHINER.

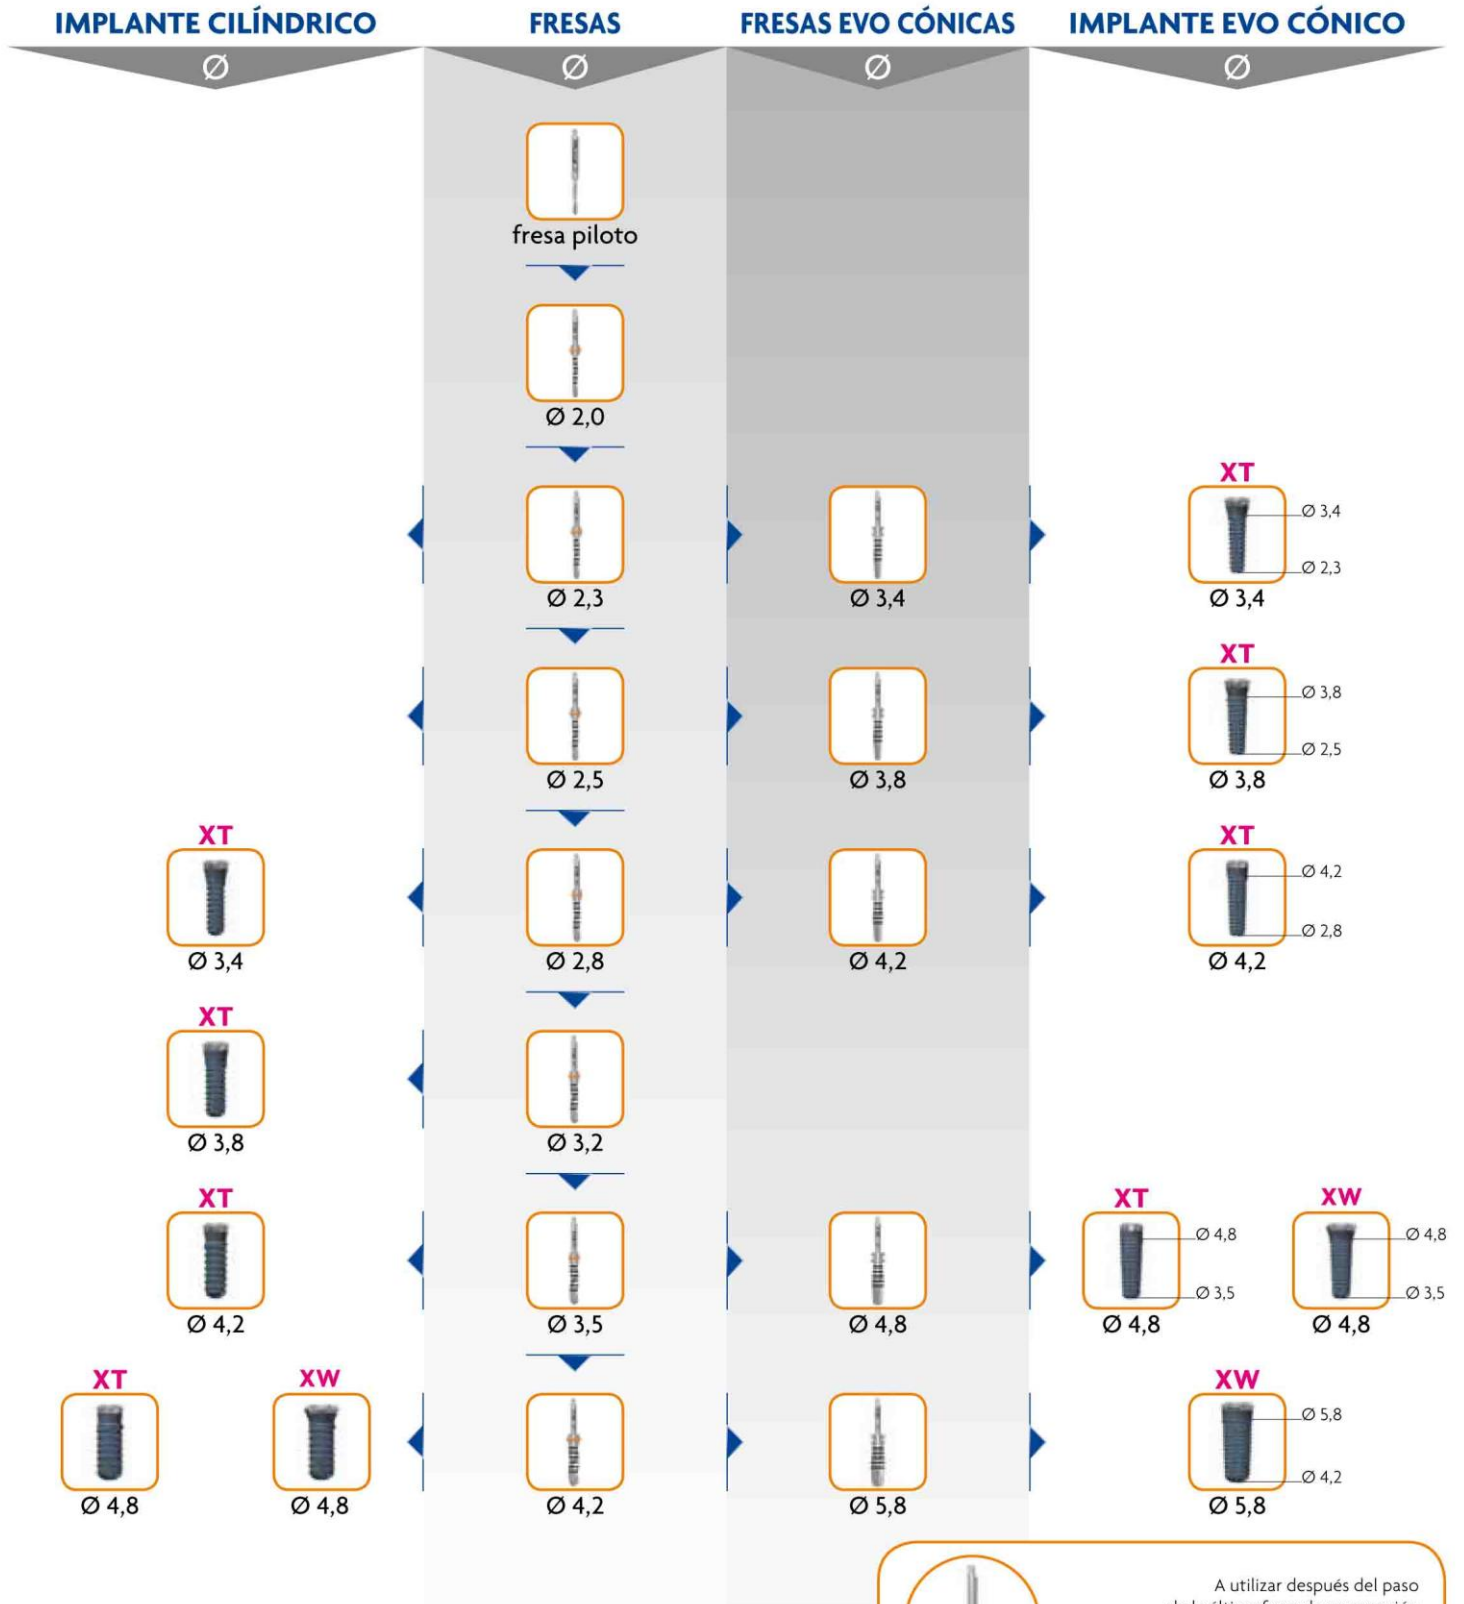

A utilizar después del paso de la última fresa de preparación del alvéolo implantar para crear el alojamiento del cuello, en el caso de hueso de consistencia D1 y D2.

DRILL NECK